



colour change / Farbvergleich
REF 08016 STEAM

before sterilization / vor der Sterilisation

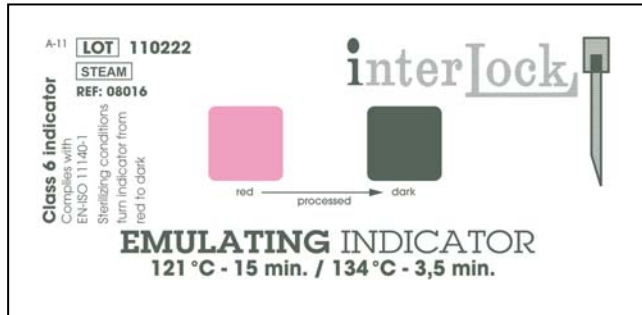


after 1 minute of sterilization / nach 1 Minute sterilisieren

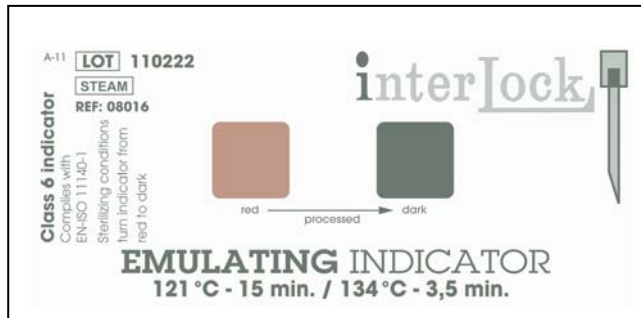


**failed /
nicht bestanden**

after 2 minutes of sterilization / nach 2 Minuten sterilisieren

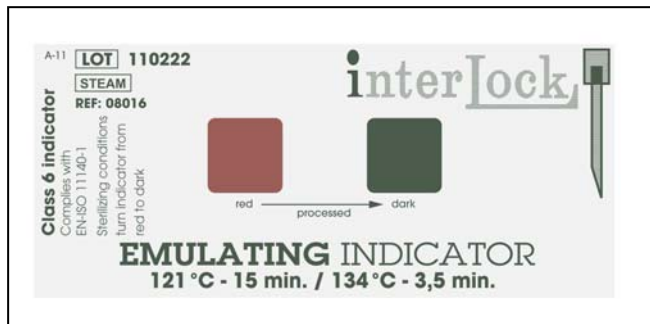

**failed /
nicht bestanden**

after 3.5 minutes of sterilization / nach 3,5 Minuten sterilisieren

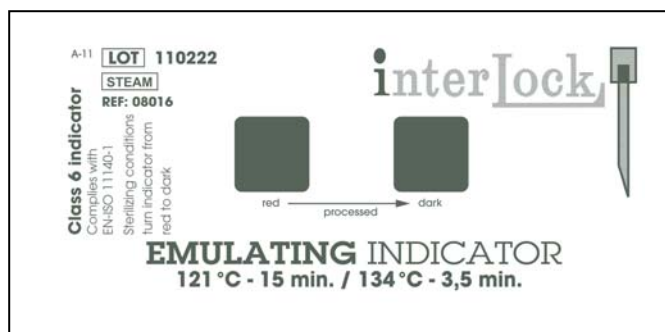

**passed /
bestanden**